


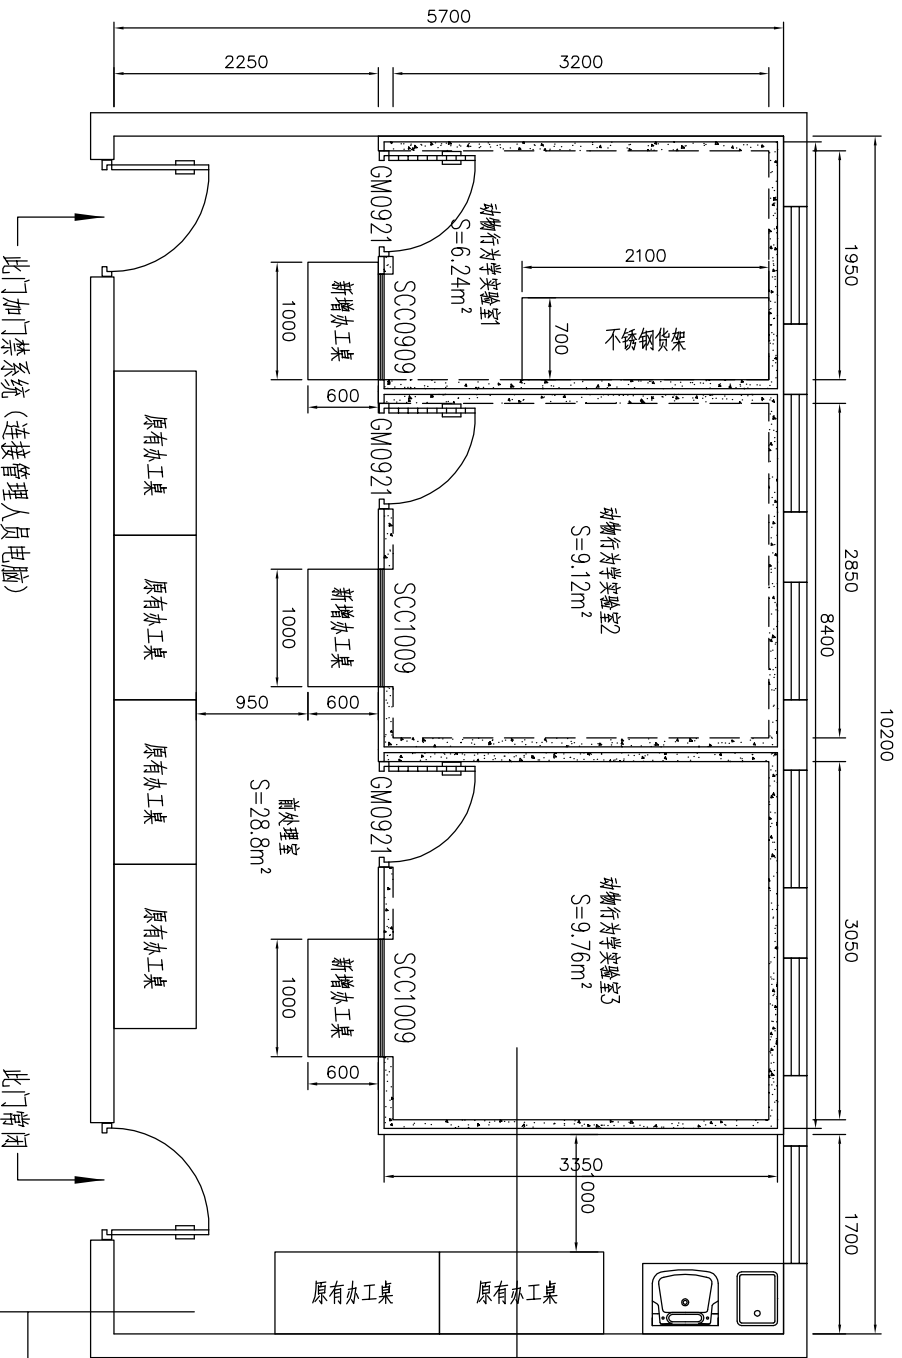

- 行为学实验室:
- 隔断: 玻璃夹心彩钢板
 - 吊顶: 铝镁合金彩钢板 (3米)
 - 内表面: 吸音装饰 (吸音棉+微孔吸音装饰板)
 - 地面: 保留原有地面 (注意成品保护)
 - 照明: 超薄LED洁净灯 (带时控开关)
 - 插座: 按需配置五孔插座
 - 空调: 小多联风管式空调机
 - 送排风: 独立新风+排风 (除味处理), 安装在对面屋顶

- 前处理室:
- 保持原有装饰
 - 新增: 办公桌宽1000*600, 3套
 - 新增: 不锈钢一体式洗手+拖把池
 - 新增: 3P壁挂式空调机
 - 新增: 入户门门禁系统 (双向控制)
 - 给排水按需改造

门窗说明:

- GM0921: 采用门套式钢制密闭门, 配双层直角观察窗 (400×600, 贴红光膜) 内充惰性气体, 配升降扫地板, 执手锁, 内填岩棉, 配不锈钢防撞带。
- SCC1009 (0909): 双层密闭观察窗 (表面贴红光膜), 配双层钢化直角玻璃, 内填干燥剂+充惰性气体。

重庆医科大学基础医学院动物行为学实验室规划方案 (北教学楼F)